

ISSET



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56069001-005-2021 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DIÁLISIS PERITONEAL, MATERIAL DE CURACIÓN Y EQUIPOS MÉDICOS, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2021.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las **09:30** horas del día **lunes 18 de octubre de 2021**, reunidos en el **AUDITORIO** del Centro de Especialidades Médicas "Dr. Julián A. Manzur Ocaña", ubicado en Cerrada de la Ceiba sin número, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86100, el Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, integrado de la siguiente manera: la **L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA**, Presidente, representada por la **C. CLAUDIA VIRIDIANA LAZO LÓPEZ**; comisionada con Oficio No. **DA/ADQ/00121/2021**, de fecha 6 de enero de 2021; la **DRA. IRMA ALEJANDRA PRIEGO GARCÍA**, Secretario; el **L.C.P. NÉSTOR RICARDO ISIDRO PÉREZ**, Primer Vocal, representado por la **L.R.C. JENNY COLORADO MORALES**, comisionada con Oficio No. **DF/DCP/6269/2021**, de fecha 14 de octubre de 2021; el **LIC. CÉSAR ANASTACIO PÉREZ PRIEGO COBIÁN**, Segundo Vocal, representado por la **C. LUCERO RODRÍGUEZ RUÍZ**, comisionada con Oficio No. **UAJ/MRP/7236/2021**, de fecha 4 de octubre de 2021, y como invitados con voz, pero sin voto, el **C. FERNANDO MORALES BORBÓN**, Director General de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Función Pública, representado por la **L.A. MILDREDT ANGÉLICA HERNÁNDEZ DE LA O.** comisionada con Oficio No. **SFP/DGNE/SN/1076/2021**, de fecha 15 de octubre de 2021; el **M.P.E. EDUARDO SALA PAVON**, Director de enlace operativo y representante de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en los Subcomités de Compras, representado por el **LIC. NICOLÁS ÁLVAREZ RUÍZ**, comisionado con Oficio No. **SAIG/SSRM/DEO/SCR/067/2021**, de fecha 30 de septiembre de 2021; por la Secretaría de Finanzas la **C. KATIA ZULEIMA ÁLVAREZ CORZO**, comisionada con Oficio No. **SF/PF/0378/2021**, de fecha 19 de abril de 2021; la **DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ**, Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, representada por la **LIC. CRISTHEL FABIOLA BAEZA MONTEJO**, comisionada con Oficio No. **CGAJ/1511/2021**, de fecha 15 de octubre de 2021 y el **DR. HUMBERTO AZUARA FORCELLEDO**, Director de Prestaciones Médicas ISSET, invitado mediante Oficio No. **SCCI/0852/2021** de fecha 28 de septiembre de 2021; como área técnica requirente los **CC. ING. GERARDO MAXIMINO BERLANGA PÉREZ**, Jefe del Departamento de Vinculación Administrativa de la Dirección de Prestaciones Médicas, comisionado con Oficio No. **DPM/5528/2021** de fecha 15 de octubre de 2021; **Q.F.B. SAMANTHA ALICIA TRUJILLO GONZÁLEZ**, Jefa de Almacén e Inventarios del CEMI, comisionada con Oficio No. **DCEM/9145/2021** de fecha 4 de octubre de 2021; **IB. JOSÉ EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ**, Biomédico del CEMI, comisionado con Oficio No. **DCEM/9142/2021** de fecha 4 de octubre de 2021 e **ING. JESÚS ALEJANDRO GUZMÁN CORNELIO**, Biomédico de la UMFC, comisionado con Oficio No. **DPM/5120/2021** de fecha 5 de octubre de 2021; **DR. OSMEL EMINALDO PEDROZO ALFONSO**, Jefe del Servicio de Nefrología del CEMI, comisionado con Oficio No. **DPM/5109/2021** de fecha 5 de octubre de 2021; **M.S.P.A.S.S. RUTH SÁNCHEZ LÓPEZ**, Jefa del Departamento de Enfermería del CEMI, comisionada con Oficio No. **DPM/5110/2021** de fecha 5 de octubre de 2021; **DR. ESTEBAN TORRES GARCÍA**, Médico Nefrólogo del CEMI, comisionado con Oficio No. **DCEM/9144/2021** de fecha 4 de octubre de 2021; con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración a las Bases y Especificaciones Técnicas de la **Licitación Pública Nacional No. 56069001-005-2021** referente a la Adquisición de Soluciones Diálisis Peritoneal, Material de Curación y Equipos Médicos,



correspondiente a las Partidas Presupuestales 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos, 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos y 53101 Equipo Médico y de Laboratorio, para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, señalada para esta fecha y hora.

Con fundamento en el artículo 36 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, de conformidad con el **Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA** de las bases de la presente **Licitación Pública** para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se realiza la presente **Junta de Aclaraciones a las Bases y Especificaciones Técnicas**.

1.- COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a comunicar, que aun cuando se invitó a participar a la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (REPRESENTACIÓN ESTATAL) mediante Oficio No. SCCI/0854/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, a la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO (REPRESENTACIÓN ESTATAL) mediante Oficio No. SCCI/0855/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021 y a la CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA (REPRESENTACIÓN ESTATAL), mediante Oficio No. SCCI/0856/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, no enviaron representante al Acto Junta de Aclaraciones.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia de los siguientes licitantes:

No.	EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL)	NOMBRE DEL ASISTENTE A ESTA REUNIÓN	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA
01	VAL BREN DE MEXICO SA DE CV	JUDIT VAZQUEZ CAMACHO	ESPECIALISTA
02	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	DOMINGO MANUEL MONTEJO TUZ	REPRESENTANTE LEGAL
03	DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV	MARÍA MERCEDES ORTÍZ LÓPEZ	APODERADO LEGAL
04	EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMENEZ	JONATHAN ALEXANDER SALAZAR LUNA	LICITACIONES
05	CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLARREAL	LICITACIONES

La **CONVOCANTE** hace la **aclaración** que se notificó mediante Oficio No. SCCI/0844/2021 a la Dirección de Finanzas del Instituto el costo y periodo de cobro de las bases de la presente licitación, haciendo referencia por error involuntario a la Licitación Pública Nacional No. 56069001-003-2021, siendo lo correcto la Licitación Pública Nacional No. 56069001-005-2021, por lo que en algunos pagos se facturó con el número de licitación erróneo, por lo que se hace la aclaración que las facturas expedidas con el número de licitación 56069001-003-2021 que estén dentro de las fechas y horarios establecidos para el pago de bases de la presente licitación, **serán tomados en cuenta y no será motivo de descalificación**.

3.- COMO TERCER PUNTO.- La convocante procede a realizar las siguientes precisiones a las bases de la presente **Licitación Pública**.

PRECISIÓN No. 1:

Con base a la MINUTA DE ACUERDOS realizados el pasado 05 de octubre en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto, situada en la Av. 27 de febrero No. 930, Col. Centro, CP. 86000, Villahermosa, Tab. y tomando en cuenta el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde



a todos iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud y el derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la lucha contra ellas, se establecen las siguientes acciones:

1.- Los medicamentos que cuenten con 18 meses o más de caducidad a la entrega, no deberán presentar CARTA COMPROMISO DE CANJE POR CADUCIDAD.

2.- Los medicamentos que tengan menos de 18 meses de caducidad a la entrega, si deberán presentar CARTA COMPROMISO DE CANJE POR CADUCIDAD.

Con fundamento en los artículos 1o. primer párrafo y 4o. cuarto y noveno párrafos de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; artículo 25 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS y artículo 12 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

Por lo que la CARTA COMPROMISO DE CANJE POR CADUCIDAD (ANEXO T) aplicará a como se especificó en los numerales 1 y 2 antes mencionados.

PRECISIÓN No. 2:

DICE:

4.5. CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS.

Los LICITANTES deberán relacionar la documentación a entregar en el "ANEXO M", resaltando en la FICHA TÉCNICA las especificaciones solicitadas: imagen del envase primario, nombre del licitante, descripción completa, presentación, marca (nombre comercial o genérico), laboratorio fabricante, registro sanitario vigente, lote de fabricación y clave de sector salud. Los **REGISTROS SANITARIOS** deberán ser entregados en **fotocopias legibles** y en medio electrónico en formato PDF en dispositivo digital (USB), libre de virus debidamente referenciado con el número de lote y anexo al que corresponde, asimismo, el archivo electrónico en PDF deberá identificarse en subcarpetas dependiendo del **ANEXO al que corresponde** como el siguiente ejemplo: **ANEXO A1: (renglón 1.pdf)**, especificando el número de renglón (lote) al que pertenecen. En el caso de que los **REGISTROS SANITARIOS** se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.

DEBE DECIR:

4.5. CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS.

Los LICITANTES deberán relacionar la documentación a entregar en el "ANEXO M", resaltando en la FICHA TÉCNICA las especificaciones solicitadas: imagen del envase primario, nombre del licitante, descripción completa, presentación, marca (nombre comercial o genérico), laboratorio fabricante, registro sanitario vigente, lote de fabricación y clave de sector salud. Los **REGISTROS SANITARIOS** deberán ser entregados en fotocopias legibles y en ambos casos las FICHAS TÉCNICAS y los REGISTROS SANITARIOS deberán entregarse en medio electrónico en formato PDF en dispositivo digital (USB), libre de virus debidamente referenciados con el número de lote y anexo al que corresponde, asimismo, el archivo electrónico en PDF deberá identificarse en subcarpetas dependiendo del ANEXO al que corresponde como el siguiente ejemplo: **ANEXO A1: (renglón 1.pdf)**, especificando el número de renglón (lote) al que pertenecen. En el caso de que los **REGISTROS SANITARIOS** se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia

simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.

4.- COMO CUARTO PUNTO.- De conformidad con el **Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Fracción III** de las bases que rigen la presente **Licitación Pública Nacional**, se hace constar que las respuestas a las preguntas técnicas de carácter legal y administrativa, notas aclaratorias y modificaciones legal y administrativa y técnicas corren a cargo del personal designado por la **CONVOCANTE**, según el **ANEXO** correspondiente y según aplique.

Se procede a contestar las preguntas recibidas en tiempo y forma a las Bases y Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública Nacional tal como se especifican en el **Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Fracción II** de las bases.

**4.1 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV**

a) De carácter administrativo y legal

CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. El numeral 4.5 indica que en la Ficha Técnica se debe resaltar el Lote de Fabricación de cada lote ofertado, lo cual no es posible saber hasta la compra del insumo. Se solicita a la convocante nos aclare si podemos colocar la leyenda "N/A" en este apartado de la Ficha Técnica.	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
2. El numeral 4.5 indica que en la Ficha Técnica se debe resaltar la Clave de Sector Salud de cada lote ofertado, las cuales no se indican en el listado de las partidas de las bases de la presente licitación. Se solicita a la convocante nos aclare si podemos colocar la leyenda "N/A" en este apartado de la Ficha Técnica.	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
3. Numeral 4.5. Se solicita a la convocante nos aclare si en las copias de los Registros Sanitarios deberán ser señalados únicamente el número de lote y anexo al que pertenecen.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
4. Anexo M. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "CSS" se deberá colocar la leyenda "N/A" o si se dejará vacía ya que en el listado de las partidas de los no viene esa información.	Se aclara al licitante que deberá poner la leyenda "N/A" en caso de que el lote no cuente con una clave de sector salud.
5. Anexo P Propuesta Técnica. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "CSS" se deberá colocar la leyenda "N/A" o si se dejará vacía ya que en el listado de las partidas de los no viene esa información.	Se aclara al licitante que deberá poner la leyenda "N/A" en caso de que el lote no cuente con una clave de sector salud.
6. Anexo Q Propuesta Económica. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "CSS" se deberá colocar la leyenda "N/A" o si se dejará vacía ya que en el listado de las partidas de los no viene esa información.	Se aclara al licitante que deberá poner la leyenda "N/A" en caso de que el lote no cuente con una clave de sector salud.
7. Anexo S. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "Total de Lotes Cotizados" se deberá	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.



CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
colocar la cantidad total en número de los lotes cotizados de cada partida.	
8. Anexo S. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "Partida" se deberá colocar el nombre de la Partida Presupuestal.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
9. Anexo S. Se solicita a la convocante nos aclare si en la columna "Cotiza o No Cotiza" se deberá colocar "Sí" y "No" de acuerdo a si se cotiza algún lote de cada partida presupuestal.	Se aclara al licitante que deberá colocar la leyenda que corresponda.
10. Numeral 5.2 Inciso m. Se solicita a la convocante nos aclare si en el caso de que el licitante no cuente con créditos fiscales firmes y/o determinados, se deberá elaborar un escrito libre indicando que este documento no aplica a la representada.	Se aclara al licitante que deberá de presentar los documentos de acuerdo a lo solicitado en el numeral.

b) De carácter técnico

CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Anexo A2 Lote 1. La convocante solicita alcohol desnaturalizado 96% c/20lts, sin embargo, el alcohol desnaturalizado tiene un porcentaje de concentración del 70% y el etílico del 96%. Se solicita a la convocante nos indique si requiere desnaturalizado 70% o etílico 96%.	Se aclara al licitante que se solicita Alcohol Desnaturalizado al 70%.
2. Anexo A2 Lote 3. Se solicita a la convocante nos aclare si se requieren las botas con plantilla o sin plantilla, ya que no especifica la descripción.	Se aclara al licitante que se solicita con plantillas.
3. Anexo A2 Lote 9. La convocante solicita guantes de nitrilo con 150 piezas, sin embargo, la presentación comercial del guante de nitrilo es de 100 piezas. Se solicita a la convocante nos permita entregar el guante de nitrilo en presentación de caja con 100 piezas.	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con la cantidad total de guantes por piezas solicitados (una caja de 100 guantes no es igual a una caja de 150 guantes que es lo solicitado).
4. En caso de responder negativamente a la pregunta anterior (pregunta 3), se solicita a la convocante nos permita entregar 1,242 cajas de guante de nitrilo en presentación de caja con 100 piezas en lugar de 828 cajas de guante de nitrilo con 150 piezas, en el caso fortuito de resultar adjudicada mi representada. Esto para poder cubrir el total de piezas de guantes que requiere el Instituto.	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.

4.2 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: INTEGRADORA MEDICA RAMA SA DE CV

a) De carácter administrativo y legal

INTEGRADORA MEDICA RAMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 1: solicitamos a la convocante entregar	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin

INTEGRADORA MEDICA RAMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
únicamente de forma impresa y en USB únicamente los Anexos que coticemos.	ser esta una limitante para los demás participantes.

b) De carácter técnico

INTEGRADORA MEDICA RAMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 2: De conformidad con el punto 4.5 CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA Solicitamos a la convocante en el caso de ser distribuidores minoristas nos acepten en original la carta de distribuidor mayorista omitiendo la entrega de la copia simple de la carta de apoyo del fabricante.	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
Pregunta 2: De conformidad con el punto 5.1.1 LAS CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA Solicitamos a la convocante en el caso de ser distribuidores minoristas nos acepten en original la carta de distribuidor mayorista omitiendo la entrega de la copia simple de la carta de apoyo del fabricante.	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
Pregunta 3: En relación al Anexo A2 garantía de los bienes donde solicitan 30 días y carta compromiso de canje por caducidad. Solicito a la convocante explique a que se refiere con garantía de 30 días y en que situación aplicaría la carta canje.	Se aclara al licitante que ya fue respondida esta pregunta en la Precisión No. 1 de la presente acta.
Pregunta 8: En relación al Anexo A2 garantía de los bienes donde solicitan 30 días y carta compromiso de canje por caducidad. Solicitamos a la convocante NO solicite carta canje ya el material de curación trae una caducidad muy amplia y los Fabricantes no entregan cartas canje.	Se aclara al licitante que ya fue respondida esta pregunta en la Precisión No. 1 de la presente acta.

**4.3 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ**

a) De carácter administrativo y legal

EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. EN EL NUMERAL 5.3 PROPUESTAS TÉCNICAS INCISO f), SOLICITAN CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ORIGINAL ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.5 DE LAS BASES, SE ENTIENDE QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UN FORMATO LIBRE PERO QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE:	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.



[Handwritten signature]

EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA, SELLADA EN ORIGINAL Y CON NÚMERO TELEFÓNICO DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL APOYO, ASÍ COMO, FIRMA AUTÓGRAFA DE QUIEN TENGA LA FACULTAD PARA ELLO; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
2. EN EL NUMERAL 5.3 PROPUESTAS TÉCNICAS INCISOS m), o), p) y q) , ESTOS INCISOS NO SON APLICABLES A MI REPRESENTADA, BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE SE MANIFIESTE LO ANTERIOR; ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación, sin ser esta una limitante para los demás participantes.

b) De carácter técnico

EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. EN EL ANEXO A2, LOTE 1 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ALCOHOL ES ETILICO AL 96% O DESNATURALIZADO 70%.	Se aclara al licitante que se solicita Alcohol Desnaturalizado al 70%.
2. EN EL ANEXO A2, LOTE 2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA TALLA DE LA BATA SOLICITADA.	Se aclara al licitante que se solicita Talla grande.
3. EN EL ANEXO A2, LOTE 3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS BOTAS SOLICITADAS SON CON PLANTILLA O SIN PLANTILLA.	Se aclara al licitante que se solicita Botas desechables con plantilla.
4. EN EL ANEXO A2, LOTE 9 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GUANTE DE NITRILLO CAJA C/100 PZAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con la cantidad total de guantes por piezas solicitados (una caja de 100 guantes no es igual a una caja de 150 guantes que es lo solicitado).
5. EN EL ANEXO A2, LOTE 9 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, ¿LOS GUANTES SON ESTÉRILES O NO ESTÉRILES?	Se aclara al licitante que se solicita guantes no estériles.
6. EN EL ANEXO A2, LOTE 18 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA TALLA SOLICITADA.	Se aclara al licitante que se solicita talla grande.
7. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3 , CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN LOS PUNTOS 5.1. Y 5.2. SOLICITAN TRENDELEMBURG DE 17° COMO MÍNIMO Y TRENDELEMBURG INVERSO 17° COMO MÍNIMO, RESPECTIVAMENTE; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELEMBURG DE 15° Y ANTITRENDELEMBURG DE 15°, RESPECTIVAMENTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
8. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3 , CAMA	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]


[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten initials 'RSL' at the bottom right]



EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 5.4. SOLICITAN SECCIÓN DE PIERNAS DE 0 A 47° COMO MÍNIMO; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SECCIÓN DE PIERNAS DE 0 A 25°, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
<p>9. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 5.5. SOLICITAN ALTURA AJUSTABLE CON DESCENSO DE 42 CM O MENOR Y ELEVACIÓN DE 82 CM O MAYOR MEDIANTE SISTEMA DE DOBLE COLUMNA; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE MÍNIMA DE 35 CM Y MÁXIMA DE 78 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>10. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 5.6. SOLICITAN CON FUNCIÓN DE REGRESIÓN PARA AYUDAR A EVITAR LA FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE 16 CM O MAYOR; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON SISTEMA DE REGRESIÓN DE 7.2 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>11. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 6. SOLICITAN ELEVACIÓN INDEPENDIENTE DEL PLANO DE PIES CON SISTEMA MECÁNICO DE 18° O MAYOR; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELEVACIÓN DE PIES SOLO CON COMBINACIÓN DE TRENDELEMBURG + RODILLAS (PIERNAS), ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>12. EN EL LOTE 1 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 12 SOLICITAN SISTEMA DE DOBLE COLUMNA; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE TIPO TIJERA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>13. EN EL LOTE 2 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN LOS PUNTOS 1.4.1 Y 1.4.2 SOLICITAN TRENDELEMBURG DE 17° Y TRENDELEMBURG INVERSO DE 17° MÍNIMO, RESPECTIVAMENTE; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELEMBURG DE 12° Y</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

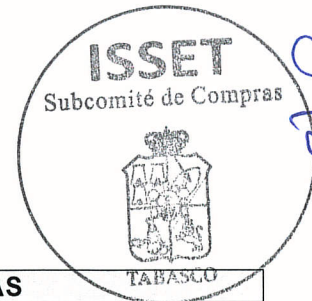

EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>TRENDELEMBURG INVERSO DE 12°, RESPECTIVAMENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	
<p>14. EN EL LOTE 2 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 1.4.4 SOLICITAN SECCION DE RODILLA O MUSLOS CUBRE UN RANGO DE 0 A 28 GRADOS; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SECCIÓN DE AJUSTE DE RODILLA QUE PUEDE LLEGAR HASTA 25° GRADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>15. EN EL LOTE 2 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 1.4.5 SOLICITAN ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE, QUE CUBRA EL RANGO DE 397 MM A 768 MM (+/- 2CM) M (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN). COMO MÍNIMO; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUEDA LLEGAR A LA ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE DE 35 CM A 70 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>16. EN EL LOTE 2 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 1.5 SOLICITAN POSICION VASCULAR O ELEVACION DE PIES; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO EN QUE SE PUEDA AJUSTAR DE FORMA MANUAL LA POSICIÓN VASCULAR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>17. EN EL LOTE 2 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 1.9 SOLICITAN DE DIMENSIONES MAXIMAS DE LA CAMA: LONGITUD TOTAL 216 CM, ANCHO TOTAL 99.5 CM; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LONGITUD TOTAL DE 220 CM DE LARGO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>18. EN EL LOTE 4 DEL ANEXO A3, CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 3.1 SOLICITAN TRENDELEMBURG DE 20° COMO MÍNIMO MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRENDELEMBURG DE 18° MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>19. EN EL LOTE 4 DEL ANEXO A3, CAMA</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin</p>



EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 3.4 SOLICITAN ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 60 A 92 CM; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 57 O MENOR EN POSICIÓN BAJA Y 90 CM O MAYOR EN POSICIÓN ALTA ACCIONADO POR PEDAL BILATERAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	ser esta una limitante para los demás participantes.
20. EN EL LOTE 4 DEL ANEXO A3 , CAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE TERAPIA INTENSIVA, EN EL PUNTO 5 SOLICITAN DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO COMO MÍNIMO; AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 211 CM DE LARGO X 78 CM DE ANCHO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
21. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PERMITA ENTREGAR PRODUCTOS CON LA LEYENDA " SECTOR SALUD " ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPOSICIÓN?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
22. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ¿LAS FICHAS TÉCNICAS PUEDEN IR EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.5.?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
23. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ¿LAS FICHAS TÉCNICAS DEBERÁN PRESENTARSE ESCANEADAS EN EL USB, JUNTO CON LOS REGISTROS SANITARIOS?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
24. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN LA FICHA TÉCNICA OMITIR EL LOTE DE FABRICACIÓN, YA QUE DICHA INFORMACIÓN SE CONOCE EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL BIEN. SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.

4.4 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: IMPACTO BIOMÉDICO SA DE CV

a) De carácter administrativo y legal

IMPACTO BIOMÉDICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Referencia: Cartas y documentos relacionados con los bienes de los anexos A1 y A2 Pregunta: Mi representada va a participar en bienes	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación, sin ser esta una limitante para los demás participantes.




IMPACTO BIOMÉDICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>descritos en el anexo A3, por lo que los documentos solicitados en el punto 5.3 incisos j), m), o), p), q), r) entre otros no aplican.</p> <p>¿Debemos solo no ponerlos en nuestra propuesta o debemos incluir una carta donde manifestemos bajo protesta de decir verdad que al no ofertar insumos de esos anexos no aplicamos?</p>	
<p>2. Referencia: Documentación Legal, Técnica y económica.</p> <p>Pregunta: La documentación que conforman nuestras propuestas Técnicas y económicas deben de ir en sobres separados, es decir en un sobre toda nuestra propuesta técnica y en otro toda nuestra propuesta económica.</p> <p>¿Todo lo que conforma la documentación legal y administrativa, la debemos presentar en otro sobre cerrado (que en total harían 3 sobres) o como es la manera de presentar esta información? Favor de aclarar</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>2. Referencia: Bases de la licitación.</p> <p>Pregunta: solicito a la convocante si nos pueden proporcionar las bases en formato Word, para así no cometer ningún error en la captura de lo solicitado en los anexos. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que las bases que se proporcionan son las mismas que se encuentran en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, denominado "Licitaciones Públicas con Normativa Nacional", ubicado en la página electrónica https://tabasco.gob.mx/licitaciones-publicas-con-normativa-estatal</p>

b) De carácter técnico

IMPACTO BIOMÉDICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Referencia: Punto 5.3 f) Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo del Fabricante o Distribuidor Autorizado en original acorde a lo establecido en el numeral 4.5 de las presentes BASES, en papel membretado de la Empresa que otorga el apoyo y con firma autógrafa de la persona facultada, selladas en original por quien otorga el apoyo y únicamente de aquellos lotes que cotiza contenidos en cada uno de los "ANEXOS A1, A2 y A3" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR, debiendo contener número de teléfono donde podrá comprobar la veracidad de la información en dicha carta, (no se aceptarán cartas escaneadas como original).</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante confirme que, en caso de entregar carta de apoyo de distribuidor primario, se deberá adjuntar la carta apostillada de distribución exclusiva que le otorga el fabricante, lo anterior para comprobar que el distribuidor primario</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>

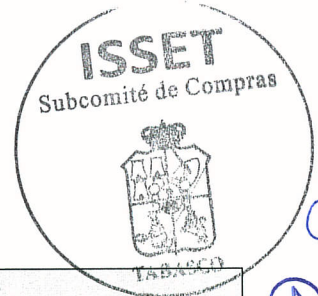

IMPACTO BIOMÉDICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>cuenta con dicho apoyo por parte del fabricante. ¿Es correcto?</p> <p>2. Referencia: Punto 4.5 tercer punto. En caso de ser Distribuidor Minorista: Original de la Carta de apoyo del Distribuidor mayorista y copias simples de la Carta de apoyo del fabricante, del Registro Sanitario, del Aviso de Funcionamiento y/o de la Licencia Sanitaria vigentes, así como original de las Fichas de Especificaciones Técnicas.</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante confirme si el aviso de funcionamiento debe corresponder al licitante en caso de que el fabricante no sea de origen nacional, ya que este documento aplica únicamente para empresas mexicanas. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

4.5 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

a) De carácter administrativo y legal

GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE REFERENTE AL NUMERAL 4.5 DE LAS PRESENTES BASES; PARA LA ENTREGA DEL ANEXO M SE ANEXARA COPIA DE LA CARTA DE APOYO Y EN EL SOBRE PROPUESTA TECNICA LA CARTA DE APOYO EN ORIGINAL, ES CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>EN REFERENCIA A LOS ANEXOS M, P, Q, EN LA COLUMNA CSS, SE LE SOLICITA LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CLAVES SS A ANEXAR EN DICHA COLUMNA PARA EL ANEXO A2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR REFERENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá poner la leyenda "N/A" en caso de que el lote no cuente con una clave de sector salud.</p>
<p>EN REFERENCIA A LOS ANEXOS M, P, Q, EN LA COLUMNA CSS, PARA EL ANEXO A3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS <u>SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI PARA ESTA COLUMNA SE COLOCARA LA LEYENDA NO APLICA.?</u></p>	<p>Se aclara al licitante que deberá poner la leyenda "N/A" en caso de que el lote no cuente con una clave de sector salud.</p>
<p>EN CASO DE NO SER NEGATIVA SU RESPUESTA FAVOR INDICAR QUE CSS DEBERA COLOCARSE EN DICHA COLUMNA</p>	




GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS ANEXOS M, P, Y Q, NOS PERMITA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ENTREGAR ÚNICAMENTE PARA LOS ANEXOS QUE COTICEMOS SEGÚN SEA EL CASO, A1, A2, A3, OMITIENDO LOS QUE NO COTICEMOS ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.

b) De carácter técnico

GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.1.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS, DADO QUE SON MÁS QUE SUFICIENTES PARA CONECTAR EL MONITOR DE SIGNOS VITALES Y UN VAPORIZADOR, Y DEJANDO 2 CONTACTOS LIBRES, ADEMÁS ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
2. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.5 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VENTILADOR BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE FUELLE YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
3. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.5.3.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PANTALLA DE 8.4" YA QUE NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ADEMÁS DE SER ESPACIO MÁS QUE SUFICIENTE PARA EL DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
4. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.7.9.3.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE DEMUESTRE QUE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO PERMITE EL USO DE LAS TRES TECNOLOGÍAS MEDIANTE CAMBIO DE MÓDULO, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
5. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.7.9.4 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR TEMPERATURA EN DOS CANALES CON DESPLIEGUE DE AMBAS TEMPERATURAS SIMULTÁNEAMENTE, LA DIFERENCIA ENTRE ELLAS Y ETIQUETA DEL SITIO DE MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
6. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.

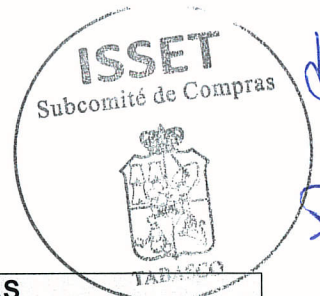

GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PUNTO 2.7.9.7.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR 2 CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON CAPACIDAD A FUTURO DE HASTA 8 PRESIONES INVASIVAS, DEBIDO A QUE CON ESTA CANTIDAD DE PRESIONES ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA QUE EL MÉDICO VALORE EL ESTADO DEL PACIENTE, ADEMÁS DE QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>7. ANEXO A3 LOTE 8 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 4.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES DE DIFERENTE MARCA A LA MÁQUINA DE ANESTESIA, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SOLO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>8. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 1.6 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MESA DE TRABAJO FIJA, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SOLO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>9. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 1.8 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR CUATRO RUEDAS, CON FRENO EN DOS DE ELLAS, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SOLO LIMITA LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>10. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 1.9 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DE LA MÁQUINA PARA UNA BUENA VISUALIZACIÓN POR PARTE DEL MÉDICO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>11. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 1.9.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MANÓMETROS CON DESPLIEGUE NUMÉRICO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>12. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 2.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VAPORIZADOR COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ANESTESIA EN CASO DE TRATARSE DEL VAPORIZADOR DE DESFLURANE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>13. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 3.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR FLUJOMETRO VIRTUAL PARA CADA GAS CÓDIFICADO DE</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten initials]

GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES. ¿SE ACEPTA?	
14. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 3.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MEZCLADOR NEUMÁTICO, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
15. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VENTILADOR BASADO EN TECNOLOGÍA DE FUELLE, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
16. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.3.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PANTALLA DE 8.4", YA QUE ES ESPACIO MÁS QUE SUFICIENTE PARA DESPLEGAR LOS PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
17. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.4.5 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.
18. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.5.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR VOLUMEN CORRIENTE DE 20 A 1500 ML, YA QUE ES UN RANGO SUFICIENTE PARA TRATAR PACIENTES DESDE NEONATOS HASTA ADULTOS. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
19. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.5.2 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PRESIÓN LÍMITE DENTRO DEL RANGO DE 10 A 70 CMH2O. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
20. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.5.3 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PRESIÓN INSPIRATORIA DE 10 A 50 CMH2O, PUES ES UN RANGO MÁS QUE SUFICIENTE PARA TRATAR PACIENTES DESDE NEONATAL HASTA ADULTO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
21. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.5.4 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR UNA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 2 A 99 RESPIRACIONES POR MINUTO. ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
22. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.5.5 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PEEP DE 3 A 20 CMH2O, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten marks on the left margin]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>23. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 5.7 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR DESPLIEGUE DE UNA CURVA A ELEGIR ENTRE CURVA DE PRESIÓN, DE FLUJO O UN LAZO DE ESPIROMETRÍA (PRESIÓN/VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN). ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>24. ANEXO A3 LOTE 9 MÁQUINA DE ANESTESIA PUNTO 7.18.6 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLÍNICA PARA EL PACIENTE Y SOLO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>25.- ANEXO A3 LOTE 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PUNTO: 5. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A. DIÁMETRO DEL CABEZAL 620 MM. B. AL TURA DEL CABEZAL 80 MM. SOLICITAMOS A LA CONVICANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A. DIÁMETRO DEL CABEZAL DE 670 MM, EL CUAL PRESENTA MAYOR DIAMETRO DE ILUMINACIÓN ABARCANDO MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, Y B. ALTURA DEL CABEZAL 50 MM, DICHA CARATERISTICA NO AFECTA EN EL FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>26.- ANEXO A3 LOTE 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PUNTO: 10. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA MÁXIMA DE 120.000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 MÓDULOS. B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 120,000 LUXES. C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX. D. TEMPERATURA DE COLOR 5,600 KELVIN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CABEZAL CON ARREGLO DE 51 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 3 MODULOS, AL SER MAYOR CANTIDAD DE LED'S SE OBTIENE MEJOR ILUMINACIÓN PARA EL CAMPO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>27.- ANEXO A3 LOTE 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PUNTO: 10. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA MÁXIMA DE 120.000 LUXES CON LAS SIGUIENTES</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



GRUPO COMERCIAL JEMA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>CARACTERISTICAS: A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 MÓDULOS. B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 120,000 LUXES. C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX. D. TEMPERATURA DE COLOR 5,600 KELVIN.</p> <p>LA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE ES FUNDAMENTAL PARA PERMITIR CAMBIAR EL CONTRASTE DE LOS TEJIDOS OBSERVADOS Y ASÍ REDUCIR LA FATIGA DEL CIRUJANO QUE AFECTA LA COMODIDAD Y LA ERGONOMÍA DEL PERSONAL MÉDICO, SIENDO SUFICIENTE UN RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE ENTRE 3000°K A 5000°K. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>28.- ANEXO A3 LOTE 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PUNTO: 11. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA MÁXIMA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS. B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 160,000 LUXES. C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX. D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 KELVIN.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CABEZAL CON ARREGLO DE 51 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 3 MODULOS, AL SER MAYOR CANTIDAD DE LED'S SE OBTIENE MEJOR ILUMINACIÓN PARA EL CAMPO DE TRABAJO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>29.- ANEXO A3 LOTE 7 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED PUNTO: 11. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA MÁXIMA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS. B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 160,000 LUXES. C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX. D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 KELVIN.</p> <p>LA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE ES FUNDAMENTAL PARA PERMITIR CAMBIAR EL CONTRASTE DE LOS TEJIDOS OBSERVADOS Y ASÍ REDUCIR LA FATIGA DEL CIRUJANO QUE AFECTA LA COMODIDAD Y LA ERGONOMÍA DEL PERSONAL MÉDICO, SIENDO SUFICIENTE UN RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE ENTRE 3000°K A 5000°K. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



4.6 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV

a) De carácter administrativo y legal

ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Del punto 4.5. Cartas de apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si las fichas de especificaciones técnicas que deberán de entregar el día miércoles 20 de octubre, se entregarán ya referenciadas o sin referenciar.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que las Fichas de Especificaciones Técnicas se deben entregar referenciadas para su posterior análisis de la convocante.</p>
<p>2. Del punto 5.1.1. Las propuestas que presentarán los licitantes, serán: técnicas y económicas, debiendo elaborarse de la siguiente forma, fracciones IV y V.</p> <p>En estas fracciones mencionan que las propuestas no podrán presentarse engrapadas o perforadas, por lo cual se solicita amablemente a la Convocante que derivado de que las propuestas se presentarán en carpetas con argollas, nos permitan presentar nuestras propuestas perforadas con la finalidad de que se puedan entregar en carpetas con argollas.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p>En caso de no ser aceptada nuestra petición, se solicita a la convocante nos informe la manera correcta de presentar nuestras propuestas.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>3. Del punto 5.2. Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas.</p> <p>Dentro de este punto se solicita se presente Actas constitutivas, reformas, poderes, e identificaciones, se solicita amablemente a la convocante nos permita presentar dichos documentos en copia certificada para cotejo y copia simple.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>4. Del punto 5.2. Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas, Inciso i).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación, que la Cédula del Registros del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco se considera original la emitida de forma electrónica y con código de verificación QR?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>5. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso a)</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que, si no ofertamos alguno de los Anexos A1, A2 y A3, no será necesario ingresar la información correspondiente a el anexo no cotizado en formato "ANEXO P" ya que no se están ofertando?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>6. Del punto 5.4 Propuestas económicas, Inciso a).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que, si no ofertamos alguno de los Anexos A1, A2 y A3, no será necesario ingresar la información correspondiente a el anexo no cotizado en formato "ANEXO Q" ya que no se están ofertando?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

b) De carácter técnico

ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Del Anexo A3, Lote 1, Cama suministro e instalación de cama de terapia intensiva.</p> <p>Punto 2. Entendemos que al ofertar carga máxima de seguridad de la cama de 250 Kg cumplimos con este punto, debido a que no se trata de una cama para un paciente bariátrico.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>2. Del Anexo A3, Lote 2, Cama hospitalaria suministro e instalación de cama hospitalaria.</p> <p>Punto 1.2. Entendemos que al ofertar carga máxima de seguridad de la cama de 250 Kg cumplimos con este punto.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>3. Del Anexo A3, Lote 2, Cama hospitalaria suministro e instalación de cama hospitalaria.</p> <p>Punto 1.4.5 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cama con una altura y descenso con un rango de 400 mm a 800 mm esto para dar mayor apertura a las marcas.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>4. Del Anexo A3, Lote 2, Cama hospitalaria suministro e instalación de cama hospitalaria.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Punto 1.9 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cama con medidas de 2200 mm de largo x 970 mm de ancho, esto para dar mayor apertura a las marcas.</p> <p>¿Se acepta?</p>	

**4.7 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV**

a) De carácter administrativo y legal

MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>4.5 CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS SE HACE MENCION EN ESTE PUNTO QUE SE ENTREGARAN COPIAS DE LAS CARTAS DE APOYO, FICHAS TECNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS, RELACIONANDOSE EN EL FORMATO "ANEXO M". PREGUNTA: ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>4.5 CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS SE HACE MENCION EN ESTE PUNTO QUE EN LAS FICHAS TECNICAS SE DEBE DE RESALTAR, IMAGEN DEL ENVASE PRIMARIO, NOMBRE DEL LICITANTE, DESCRIPCION COMPLETA, PRESENTACION, MARCA, LABORATORIO FABRICANTE, REGISTRO SANITARIO, LOTE DE FABRICACION Y CLAVE DEL SECTOR SALUD. EN ESTE CASO EL LOTE DE FABRICACION, DADO QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS SERAN NUEVOS POR LO TANTO NO CONTAMOS CON LA INFORMACION DEL LOTE DE FABRICACION. BASTARIA CON PONER NO APLICA O SIN NUMERO DE LOTE. PREGUNTA: ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>4.5 CARTAS DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIAS SANITARIAS SE HACE MENCION EN ESTE PUNTO QUE EN UN DISPOSITIVO USB SERAN ENTREGADOS COPIAS REFERENCIADOS POR NUMERO DE LOTE Y</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta ya fue respondida en la Precisión No. 2 de la presente acta de Junta de Aclaraciones.</p>



MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ANEXO LOS REGISTROS SANITARIOS EN FORMATO PDF. PREGUNTA: ¿SOLAMENTE LOS REGISTROS SANITARIOS SERAN ENTREGADOS EN FORMATO PDF EN USB COMO SE MENCIONA EN ESTE PUNTO?	
5.3 PROPUESTA TECNICA "ANEXO P" DADO QUE SE ESTAN MANEJANDO 3 ANEXOS (A1, A2, Y A3), NOS PERMITIRIA LA CONVOCANTE OFERTAR SOLAMENTE EL ANEXO EN EL CUAL ESTAMOS PARTICIPANDO. PREGUNTA: ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.
5.4 PROPUESTA ECONOMICA "ANEXO Q" DADO QUE SE ESTAN MANEJANDO 3 ANEXOS (A1, A2, Y A3), NOS PERMITIRIA LA CONVOCANTE OFERTAR SOLAMENTE EL ANEXO EN EL CUAL ESTAMOS PARTICIPANDO. PREGUNTA: ¿SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.

b) De carácter técnico

MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Sin Preguntas	Sin Respuestas

**4.8 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
RICARDO PÉREZ CÓRDOVA**

a) De carácter administrativo y legal

RICARDO PÉREZ CÓRDOVA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Numeral 4.5 Carta de Apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencias sanitarias. Se solicita a la convocante aclare si ¿el aviso de funcionamiento solicitado es del licitante o del fabricante?	Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.

b) De carácter técnico

RICARDO PÉREZ CÓRDOVA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. De acuerdo al anexo A3 "especificaciones técnicas de los bienes a ofertar", lotes 1, 2, 4, 7, 8, 9 y 10, solicito a la convocante, me aclare cada cuanto requiere que se realicen los mantenimientos preventivos, durante cuánto tiempo y el alcance de estos.	Se aclara al licitante que el mantenimiento es conforme se especifique en los manuales del fabricante a ofertar, realizados por personal especializado.

RICARDO PÉREZ CÓRDOVA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
2. De acuerdo al anexo A3 "especificaciones técnicas de los bienes a ofertar", lotes 1, 2, 4, 7, 8, 9 y 10, solicito a la convocante, me aclare el lapso que requiere se realicen los mantenimientos preventivos descritos en la descripción de los lotes.	Se aclara al licitante que los periodos del mantenimiento es conforme se especifique en los manuales del fabricante a ofertar, realizados por personal especializado.

**4.9 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
SERVANDO TADEO LÓPEZ VIDAL**

a) De carácter administrativo y legal

SERVANDO TADEO LÓPEZ VIDAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Se solicita amablemente a la convocante especificar talla o medida así como la cantidad por medida o talla de los siguientes lotes 2,17 y 18 del anexo A2	Se aclara al licitante que las tallas son las siguientes: Lote 2: Talla grande Lote 17: Talla extra grande Lote 18: Talla grande

b) De carácter técnico

SERVANDO TADEO LÓPEZ VIDAL

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Sin Preguntas.	Sin Respuestas.

**4.10 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
VAL BREN DE MEXICO SA DE CV**

a) De carácter administrativo y legal

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Sin Preguntas.	Sin Respuestas.

b) De carácter técnico

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- ANEXO A2 REFERENTE A MATERIAL DE CURACION: Lote 2: Batas Quirúrgicas desechables... Pregunta: ¿Agradecemos a la convocante nos indique la talla requerida para esta partida, CHICA, MEDIANA O GRANDE?	Se aclara al licitante que se solicita talla grande.
2.- ANEXO A2 REFERENTE A MATERIAL DE CURACION: Lote 17: Traje desechable con capucha... Pregunta: ¿Agradecemos a la convocante nos indique la talla requerida para esta partida, CHICA, MEDIANA O GRANDE?	Se aclara al licitante que se solicita talla extra grande.

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>3.- ANEXO A2 REFERENTE A MATERIAL DE CURACION Lote18: Traje de cirujano, filipina y pantalón desechable, composición 50% polipropileno y 50% polietileno. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Traje de cirujano filipina y pantalón, fabricado en tela no tejida sms, grado médico, 100% polipropileno, impermeable, repelente a la penetración de líquidos y fluidos, no transparente, antiestática. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>4.- ANEXO A2 REFERENTE A MATERIAL DE CURACION Lote18: Traje de cirujano, filipina y pantalón desechable... Pregunta: ¿Agradecemos a la convocante nos indique la talla requerida para esta partida, CHICA, MEDIANA O GRANDE?</p>	<p>Se aclara al licitante que se solicita talla grande.</p>
<p>1.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 1 ESTRUCTURA DE LA CAMA FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar una estructura de la cama fabricada en tubo de acero con revestimiento epoxy. Ya que esto no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>2.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.1 TRENDELEMBURG DE 17° COMO MÍNIMO Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir una tolerancia de $\pm 1^\circ$, ya que esta diferencia no repercute en la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>3.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.2 TRENDELEMBURG INVERSO 17° COMO MÍNIMO Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir una tolerancia de $\pm 1^\circ$, ya que esta diferencia no repercute en la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>4.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.4 SECCIÓN DE PIERNAS DE 0 A 47° COMO MÍNIMO</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un rango de 0 a 32°. ¿Se acepta?</p>	
<p>5.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.5 ALTURA AJUSTABLE CON DESCENSO DE 42 CM O MENOR Y ELEVACIÓN DE 82 CM O MAYOR MEDIANTE SISTEMA DE DOBLE COLUMNA</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir una tolerancia de $\pm 5\%$, ya que esta diferencia no repercute en la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>6.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.6 CON FUNCIÓN DE REGRESIÓN PARA AYUDAR A EVITAR LA FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, DE 16 CM O MAYOR.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el referenciar esta característica como sistema de doble regresión de la cama que permite ajustar los movimientos de la sección del respaldo (11 cm) y la pélvica (7 cm) Reduciendo al mínimo la fricción, ya que así es como el fabricante describe lo solicitado. ¿Es correcta la apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>7.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 5.7 FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS PARA CPR DE EMERGENCIA POSICIÓN DE SILLA CARDIACA Y POSICIÓN DE EXAMEN.</p> <p>Pregunta: entendemos que se refieren a que el equipo debe contar con un panel de control con botones para dar CPR de emergencia, posición de silla cardiaca y posición de examen. ¿Es correcta la apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>8.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 6 ELEVACIÓN INDEPENDIENTE DEL PLANO DE PIES CON SISTEMA MECÁNICO DE 18° O MAYOR</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>9.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 10 DIMENSIONES DE LA CAMA DE 220 CM DE LARGO X 97 CM DE ANCHO</p> <p>Pregunta: puesto que las dimensiones internas de la cama deben tener congruencia con las dimensiones externas, solicitamos amablemente a la convocante que se nos permita ofertar dimensiones de la cama de 213 cm de largo x 94 cm de ancho. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>10.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 11 OPCIÓN DE EXTENSIÓN DEL BASTIDOR DE LA CAMA DE 30 CM</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir una tolerancia de ±10 cm, ya que esta diferencia no repercute en la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>11.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 12 SISTEMA DE DOBLE COLUMNA</p> <p>Pregunta: entendemos que las columnas deben ser telescópicas, de 6 perfiles que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>12.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 14 BARANDALES LATERALES EN MATERIAL POLIPROPILENO, ABATIBLES CON SISTEMA AMORTIGUADO MEDIANTE PISTÓN A GAS. DOS EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar barandales laterales en material HDPE, que cumple con la normativa EN 60601-2-52, amortiguado mediante pistón a gas, dos en sección de cabeza y dos en sección de pies ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>13.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: Puntos de 16.1 a 16.7</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un colchón de la misma marca de la cama, con las siguientes características: La parte superior del colchón es de viscoelástica con densidad de HR60 de grafeno multizona, con alta permeabilidad, con diseño ergonómico favoreciendo</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>la relajación del cuerpo y la distribución del peso, para liberar los puntos de presión y prevenir frente a las úlceras de cubito. Este colchón puede ser utilizado con pacientes con úlceras de grado III. La capa intermedia del Visco Respirel con HR50 tiene una importante propiedad, es reticulada, igualmente mantiene una gran permeabilidad al aire, favoreciendo la transpiración del colchón y respondiendo a las máximas exigencias de comodidad, frescura y durabilidad. La parte inferior del colchón está compuesta por una espuma de poliuretano de HR35 Biocell de alta resiliencia, que aumenta más, la adaptabilidad del colchón. El núcleo del colchón se compone de espuma más densa, gracias a la cual el colchón tiene una capacidad de carga de 230 kg.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
<p>14.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 16.8 FUNDA DE TEJIDO BIELÁSTICO, RETARDANTE AL FUEGO. IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE. ANTIALÉRGICA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° C COMO MINIMO. CON CREMALERA EN L O EN U.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante que la funda del colchón sea lavable y esterilizable de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, ya que esto no aporta ninguna ventaja clínica en la recuperación del paciente.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>15.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 24.1 DESPLIEGUE DEL PESO EN KILOGRAMOS EN PANTALLA DIGITAL DE AL MENOS 4 DÍGITOS</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar un despliegue del peso en kilogramos en pantalla digital de al menos 3 dígitos.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>16.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 24.3 RESOLUCIÓN SELECCIONABLE DE 0.5 O 0.1</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar este punto de manera opcional.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases</p>
<p>17.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 1: CAMA TERAPIA INTENSIVA Punto: 24 4 FUNCIÓN DE MEMORIA</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'du', 'R', and 'PBB']

[Handwritten signature]

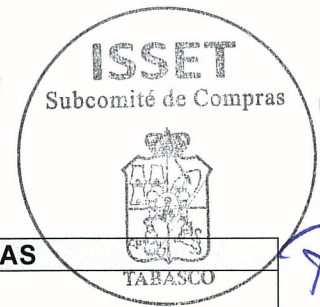

[Handwritten initials]

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar la función de detección de salida del paciente. ¿Se acepta?</p>	
<p>18.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.4.1. TRENDELEMBURG DE 17°.</p> <p>Pregunta: con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar un ángulo de 16° ya que esto no demerita el correcto funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>19.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.4.2. TRENDELEMBURG INVERSO DE 17° MÍNIMO.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar un ángulo de 16° ya que esto no demerita el correcto funcionamiento del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>20.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.4.4. ÁNGULO DE EXTREMIDADES QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 45° COMO MÍNIMO.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante que nos permitan hacer referencia a lo solicitado como: inclinación de los pies. Ya que es así como el fabricante se refiere a lo solicitado. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>21.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.8 DIMENSIONES DEL PACIENTE: 198 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO COMO MINIMO.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar dimensión superficie paciente de 200 x 85 cm. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>22.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.9 DE DIMENCIONES MAXIMAS DE LA CAMA: LONGITUD TOTAL 216 CM, ANCHO TOTAL 99.5 CM.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar dimensión externa de la cama de 210 x 94 cm.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿Se acepta?</p> <p>23.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 2: CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA Punto: 1.13 COLCHÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 14 CM (+/-5%) DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA, RADIOLUCIDO, CON DISEÑO PARA LA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, CON FUNDA BACTERIOSTATICA Y FUNGISTATICA, CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE E IMPERMEABLE, CON SISTEMA DE COSTURAS OCULTAS QUE SEA LIBRE DE LATEX.</p> <p>Pregunta: con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un colchón de la misma marca de la cama, con las siguientes características: La parte superior del colchón es de viscoelástica con densidad de HR60 de grafeno multizonal, con alta permeabilidad, con diseño ergonómico favoreciendo la relajación del cuerpo y la distribución del peso, para liberar los puntos de presión y prevenir frente a las úlceras de cubito. Este colchón puede ser utilizado con pacientes con úlceras de grado III. La capa intermedia del Visco Respirel con HR50 tiene una importante propiedad, es reticulada, igualmente mantiene una gran permeabilidad al aire, favoreciendo la transpiración del colchón y respondiendo a las máximas exigencias de comodidad, fresca y durabilidad. La parte inferior del colchón está compuesta por una espuma de poliuretano de HR35 Biocell de alta resiliencia, que aumenta más, la adaptabilidad del colchón. El núcleo del colchón se compone de espuma más densa, gracias a la cual el colchón tiene una capacidad de carga de 230 kg.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>24.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE Punto: 3.1 TRENDELEMBURG DE 20° COMO MÍNIMO MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO BILATERAL y 3.2 TRENDELEMBURG INVERSO DE 20° COMO MÍNIMO MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO BILATERAL</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar un ajuste de trendelemburg y trendelemburg inverso por medio de un sistema de cilindro de aire, accionado mediante palanca bilateral.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>25.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Punto: 3.1 TRENDELEMBURG DE 20° COMO MINIMO MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO BILATERAL y 3.2 TRENDELEMBURG INVERSO DE 20° COMO MÍNIMO MEDIANTE PEDAL HIDRÁULICO BILATERAL.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar un ajuste de trendelemburg de 16° y trendelemburg inverso de 8°.</p> <p>¿Se acepta?</p>	
<p>26.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE Punto: 3.4 ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 80 A 92 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO SIN COLCHÓN). COMO MÍNIMO MEDIANTE COLUMNAS. ACCIONADO POR PEDAL BILATERAL</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar altura y descenso ajustable que cubre el rango de 55 a 79 cm (medido de la superficie de la camilla al piso sin colchón) como mínimo accionado por pedal bilateral. Ya que una altura mayor no representa una ventaja clínica para el paciente.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>27.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE Punto: 5 DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO COMO MINIMO</p> <p>Pregunta: con la finalidad de no limitar la libre participación, y puesto que las dimensiones internas deben tener congruencia con las dimensiones externas de la camilla, solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar dimensiones de la superficie del paciente de 185 cm de largo x 72 cm de ancho.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>28.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE Punto: 6 DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL 214 CM. ANCHO TOTAL 77 CM ± 2 CM.</p> <p>Pregunta: con la finalidad de no limitar la libre participación, y puesto que las dimensiones externas deben tener congruencia con las dimensiones internas de la camilla, solicitamos amablemente a la convocante permitir una tolerancia de ± 5 cm.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿Se acepta?</p> <p>29.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 4: CAMILLA DE TRANSPORTE Punto: 9 COLCHÓN DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR COMO MINIMO, DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON CAPA SUPERFICIAL DE ESPUMA VISCOELÁSTICA. CON RECUBRIMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ANTIBACTERIANO. IMPERMEABLE. LIBRE DE MATERIALES PELIGROSOS. RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A 134°.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar un colchón que se pueda lavar y desinfectar de acuerdo con la tecnología de cada fabricante.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>30.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.1.1. LED BLANCO SIN EMITIR NINGÚN TIPO DE RAYOS INFRARROJOS. NO MAYOR A 32 BULBOS DE LED.</p> <p>Pregunta: debemos entender que la lámpara debe contar con luz led blanca, que cumpla con el estándar de seguridad fotobiológico.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>¿Es correcto?</p> <p>31.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.1.1. LED BLANCO SIN EMITIR NINGÚN TIPO DE RAYOS INFRARROJOS. NO MAYOR A 32 BULBOS DE LED.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar led blanco sin emitir ningún tipo de rayos infrarrojos con 36 bulbos de led. Ya que esto no representa ninguna desventaja funcional del equipo y se cumple con el diámetro y peso del cabezal solicitados.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>32.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.14. AL MENOS 10 NIVELES DE AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ, ENTRE 20%-100%</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un ajuste de la intensidad de luz en al menos 5 niveles, entre el 28 al 100%. Ya que esta diferencia no representa ninguna desventaja clínica para el paciente.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>33.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the table]

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin of the table]



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Punto: 4.1.5. AL MENOS TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: GENERAL. COMPLETA Y AMBIENTAL PARA CIRUGÍAS DE MÍNIMA INVASIÓN</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un modo general de iluminación, y un tipo de luz para endoscopia. ¿Se acepta?</p>	
<p>34.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.1.6. CAPACIDAD DE REEMPLAZAR SOLO EL LED EN MAL ESTADO. EN CASO DE REQUERIRSE NO SE ACEPTA REEMPLAZO DEL MÓDULO GENERAL</p> <p>Pregunta:, solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar una capacidad de reemplazo de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, ya que esto no representa una ventaja clínica en el paciente. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>35.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.2. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 4350 GRADOS KELVIN.</p> <p>Pregunta: entendemos que el ofertar una temperatura de color fija de 4500 kelvin no será motivo de descalificación ya que supera lo solicitado. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>36.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 4.3. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96 COMO MÍNIMO. ÍNDICE DE SATURACIÓN DE COLOR ROJO R9 DE 97 COMO MÍNIMO.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar un índice de rendimiento de color Ra de 95 como mínimo. Índice de saturación de color rojo R9 de 92 como mínimo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>37.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: A. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO.</p> <p>Pregunta: entendemos que se refieren a que la lámpara deberá contar con un mango en dos elementos (mango y anillo) que se pueden girar. ¿Es correcta la apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases</p>
<p>38.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Punto: B. JUNTAS DE SILICONA</p> <p>Pregunta: entendemos que se refieren a que la el satélite y las pantallas de protección se pueden limpiar y desinfectar. ¿Es correcta la apreciación?</p>	
<p>39.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: C. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el referenciar este punto como "pantallas de protección". ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>40.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: E. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA</p> <p>Pregunta: entendemos que se requiere un panel de control en cada satélite desde donde se pueda operar la lámpara. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>41.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: A. DIÁMETRO DEL CABEZAL 620 MM.</p> <p>Pregunta: con el fin de fomentar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar un diámetro de 55 cm o mayor. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>42.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: B. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM.</p> <p>Pregunta: Entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una altura del cabezal considerando el mango de 26 cm. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>43.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: A. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS.</p> <p>Pregunta: Entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar el enfoque electrónico en 5 niveles, los cuales son indicados mediante 5 ledes en el panel de control. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>44.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: 10. UN CABEZAL CON INTENSIDAD</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink along the right margin of the table, including a large 'd' at the top and various initials and signatures below.

Handwritten notes and signatures in blue ink along the left margin of the table, including a large 'J' and other initials.



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>LUMINOSA HOMOGÉNEA MÁXIMA DE 120,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una intensidad luminosa de 160,000 luxes, ya que esto representa una característica superior a la solicitada. ¿Es correcto?</p>	
<p>45.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA SENCILLA Punto: A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 MÓDULOS. Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar un arreglo de 36 ledes de alta calidad los cuales garantizan alcanzar la intensidad luminosa solicitada. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>46.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 120,000 LUXES. Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una intensidad luminosa de 160,000 luxes, ya que esto representa una característica superior a la solicitada. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>47.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX. Pregunta: entendemos que la lámpara deberá contar con de endoscopia. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>48.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: D. TEMPERATURA DE COLOR 5,600 KELVIN Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación un rango de temperatura ajustable en 3750, 4000, 4250, 4500 y 4750 K (Kelvin) en donde se pueden ajustar en la lámpara estándar (3750 K en luz cálida roja, 4750 K en luz fría azul). Esto le permite al usuario seleccionar la temperatura de color óptima de la lámpara para el tipo particular de tejido y la estructura del área de la herida. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>49.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>

[Handwritten signatures and initials]



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>CM</p> <p>Pregunta: entendemos que se requiere un campo de luz ajustable de 18 a 30 cm. ¿Es correcto?</p>	
<p>50.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN 1.3 M</p> <p>Pregunta: con el fin de fomentar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 91.5 cm de profundidad de iluminación ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>51.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: I. RELACIÓN EE/EC 3.5 (MW/M2) /LUX.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una eficiencia luminosa de 279 lm/W. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>52.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar un arreglo de 36 ledes de alta calidad los cuales garantizan alcanzar la intensidad luminosa solicitada. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>53.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 160,000 LUXES.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una intensidad luminosa de 160,000 luxes, ya que esto representa una característica superior a la solicitada. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>54.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX</p> <p>Pregunta: entendemos que la lámpara deberá contar con de endoscopia. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>55.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5,600 KELVIN.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten initials]

[Handwritten arrow pointing down]

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación un rango de temperatura ajustable en 3750, 4000, 4250, 4500 y 4750 K (Kelvin) en donde se pueden ajustar en la lámpara estándar (3750 K en luz cálida roja, 4750 K en luz fría azul). Esto le permite al usuario seleccionar la temperatura de color óptima de la lámpara para el tipo particular de tejido y la estructura del área de la herida. ¿Se acepta?</p>	
<p>56.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN 1.3 M</p> <p>Pregunta: con el fin de fomentar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 91.5 cm de profundidad de iluminación ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>57.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 7: LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA Punto: I. RELACIÓN EE/EC 3.5 (MW/M2) /LUX.</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar una eficiencia luminosa de 279 lm/W. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>58.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.1.2 CON AL MENOS SEIS CONTACTOS, ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos o integrados. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>59.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS.</p> <p>Pregunta: Entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar un indicador de presión en la pantalla del equipo. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>60.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>Pregunta: Entendemos que esta característica se podrá ofertar de manera opcional.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿Es correcto?</p> <p>61.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.5 VENTILADOR MICROPROCESADO, INTERCONSTRUÍDO O INTEGRADO, DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA CON TECNOLOGÍA DE PISTÓN, TURBINA O REFLECTOR DE VOLUMEN, QUE PERMITA CONTINUAR CON LA VENTILACIÓN EN CASO DE FALLA TOTAL DE LOS GASES:</p> <p>Pregunta: Entendemos que esta característica se podrá ofertar de manera opcional.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>62.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.5.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 15 A 70 CM H2O. Pregunta: entedeos que ofertar una presión límite de 6 a 60 CH2O no será motivo de descalificación, ya que se encuentra dentro del rango solicitado.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>63.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 8: MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA Punto: 2.7.1 MONITOR MODULAR (INDICAR MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO DE CADA MÓDULO)</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente al a convocante permitir ofertar monitores preconfigurados o modulares, ya que un monitor preconfigurado puede cumplir con las mismas funciones que un modular.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>64.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 1.3 CON AL MENOS CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUÍDOS.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos o integrados.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>65.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 1.5,- CON AL MENOS UN CAJÓN CON LLAVE.</p> <p>Pregunta, solicitamos amablemente a la convocante que la cerradura en los cajones sea opcional, ya que esto no representa ninguna ventaja clínica.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>66.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 1.8.- CUATRO RUEDAS, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar cuatro ruedas, dos con freno. ¿Se acepta?</p>	<p>ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>67.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA</p> <p>Punto: 1.9.- MANÓMETROS DIGITALES CON DESPLIEGUE EN PANTALLA. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (02 - VERDE, N20AZUL, AIRE-AMARILLO):</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar manómetros neumáticos. codificados de acuerdo al código americano de colores (02 - verde, N20 azul, aire- amarillo): ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>68.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 1.9.2. DOS PARA CILINDROS (02, N20) QUE DESPLIEGUE DE FORMA GRAFICA EL NIVEL DE LLENADO DEL TANQUE.</p> <p>Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante permitirnos ofertar esta característica de forma opcional. ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>69.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 1.11.- CON ILUMINACIÓN AJUSTABLE PARA EL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>Pregunta: entendemos que bastará con referenciar que el equipo cuenta con iluminación. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>70.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 2.1.- SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR A ELECCIÓN DEL USUARIO (SEVOFLURANE O DESFLURANE)</p> <p>Pregunta: entendemos que se deberá suministrar un vaporizador de sevoflurane. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>71.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>



VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 2.2,- CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE.</p> <p>Pregunta: entendemos que esta característica se ofertará según la tecnología de cada fabricante.</p> <p>¿Es correcto?</p>	
<p>72.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 3.1.- FLUJÓMETROS VIRTUAL CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA CON HERRAMIENTAS GRÁFICAS PARA EL USO DE FLUJOS BAJOS. 3.1.1 CON AJUSTE EN PANTALLA DEL FLUJO TOTAL DEL GAS FRESCO Y DESPLIEGUE DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO</p> <p>Pregunta: entendemos que esta característica se ofertará según la tecnología de cada fabricante.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>73.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 3.1.2,- DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL FLUJÓMETRO VIRTUAL PARA CADA GAS MEDICINAL CODIFICADO DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: 02- VERDE, AIRE-AMARILLO, N20-AZUL.</p> <p>Pregunta: entendemos que esta característica se ofertará según la tecnología de cada fabricante.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>74.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 3.2.- MEZCLADOR ELECTRÓNICO</p> <p>Pregunta: entendemos que no será motivo de descalificación el ofertar un mezclador neumático.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>75.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 4.10,- BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILADOR MANUAL</p> <p>Pregunta: entendemos que esta característica se podrá ofertar de forma opcional.</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>
<p>76.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin</p>

VAL BREN DE MEXICO SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 5.3.2,- TAMAÑO MÍNIMO DE 15".</p> <p>Pregunta: con el fin de fomentar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una pantalla de 12" ¿Se acepta?</p>	<p>ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>77.- ANEXO A3 EQUIPO MEDICO Lote 9: MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA Punto: 5.5.2,- PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 80 CMH20.</p> <p>Pregunta: con el fin de fomentar la libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un rango de hasta 60cmH2O ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse a las bases.</p>

4.11 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV

a) De carácter administrativo y legal

DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Pregunta 1: Solicitamos a la convocante poder entregar de forma impresa solo los anexos cotizados.</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su petición, sin ser esta una limitante para los demás participantes.</p>
<p>Pregunta 2: Solicitamos a la convocante nos aclara si es necesario incluir de forma Digital los anexos No cotizados con la leyenda No cotizo u omitir dichos anexos No cotizados.</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario.</p>
<p>Pregunta 3: Por ser una licitación de carácter nacional, solicitamos a la convocante poder ofertar algunos productos de procedencia extranjera.</p>	<p>Se aclara al licitante que debe apegarse al Punto 4.5 de las bases de la presente licitación.</p>

b) De carácter técnico

DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Pregunta 3: Con relación al Anexo A2 en las condiciones de entrega solicitan Garantía de 30 Días mas carta compromiso de canje por caducidad "Anexo T" solicito a la convocante nos aclaren a que se refieren en dicho punto.</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se respondió en la Precisión No. 1 de la presente acta.</p>
<p>Pregunta 7: 5.3 Propuesta Técnica inciso p) solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si este inciso solo es informativo o es un Escrito bajo protesta de decir verdad?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá entregar Escrito bajo protesta de decir verdad referente al inciso p) del Punto 5.3 de las bases de la presente licitación.</p>



5.- COMO QUINTO PUNTO.- Una vez dadas las respuestas a las preguntas realizadas en la presente reunión, se procede al cierre y lectura del acta correspondiente a la **Junta de aclaraciones** de las bases de la Licitación Pública Nacional No. 56069001-005-2021.

6.- COMO SEXTO PUNTO.- Se ratifica a los presentes que el acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se realizará a las 09:30 horas del día lunes 25 de octubre de 2021, en el **AUDITORIO** del Centro de Especialidades Médicas "Dr. Julián A. Manzur Ocaña", ubicado en Cerrada de la Ceiba sin número, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86100, conforme a lo establecido en el **Punto 6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS** de las Bases de la presente licitación.

No habiendo otro asunto que tratar y no existiendo más preguntas formuladas ni comentarios a las bases por parte de los licitantes y precisiones del Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo las 18:00 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente, para dar constancia a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, manifestando que la falta de firma de alguno de los asistentes, no invalidará el acto, con fundamento en el artículo 36 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, firmando en **cinco** tantos al margen y al calce para constancia de los servidores públicos que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

FUNCIÓNARIO	CARGO	FIRMA	RÚBRICA
C. CLAUDIA VIRIDIANA LAZO LÓPEZ	Representante de la Presidente		
DRA. IRMA ALEJANDRA PRIEGO GARCÍA	Secretario		
L.R.C. JENNY COLORADO MORALES	Representante del Primer Vocal		
C. LUCERO RODRÍGUEZ RUÍZ	Representante del Segundo Vocal		

INVITADOS

FUNCIÓNARIO	CARGO Y DEPENDENCIA	FIRMA	RÚBRICA
L.A. MILDREDT ANGÉLICA HERNÁNDEZ DE LA O	Representante de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco		
LIC. NICOLÁS ÁLVAREZ RUÍZ	Representante de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en los Subcomités de Compras		
C. KATIA ZULEIMA ÁLVAREZ CORZO	Representante de la Secretaría de Finanzas		
LIC. CRISTHEL FABIOLA BAEZA MONTEJO	Representante de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos		
DR. HUMBERTO AZUARA FORCELLEDO	Director de Prestaciones Médicas ISSET		

POR EL ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE

NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FIRMA	RÚBRICA
ING. GERARDO MAXIMINO BERLANGA PÉREZ	Jefe del Departamento de Vinculación Administrativa de la Dirección de Prestaciones Médicas		
Q.F.B. SAMANTHA ALICIA TRUJILLO GONZÁLEZ	Jefa de Almacén e Inventarios del CEMI		
ING. JESÚS ALEJANDRO GUZMÁN CORNELIO	Biomédicos de la UMFC		
DR. OSMEL EMINALDO PEDROZO ALFONSO	Jefe del Servicio de Nefrología del CEMI		
IB. JOSÉ EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ	Biomédico del CEMI		
M.S.P.A.S.S. RUTH SÁNCHEZ LÓPEZ	Jefa del Departamento de Enfermería del CEMI		
DR. ESTEBAN TORRES GARCÍA	Médico Nefrólogo del CEMI		

LICITANTES

EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL)	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA	FIRMA	RÚBRICA
VAL BREN DE MEXICO SA DE CV	JUDIT VAZQUEZ CAMACHO	ESPECIALISTA		
ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	DOMINGO MANUEL MONTEJO TUZ	REPRESENTANTE LEGAL		
DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV	MARÍA MERCEDES ORTÍZ LÓPEZ	APODERADO LEGAL		
EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMENEZ	JONATHAN ALEXANDER SALAZAR LUNA	LICITACIONES		
CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO SA DE CV	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLARREAL	LICITACIONES		

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMA.